


Sepid Tan Parniyan Co.
Manufacturer of Orthopedic &
Physiotherapy Appliance

Product Catalogue

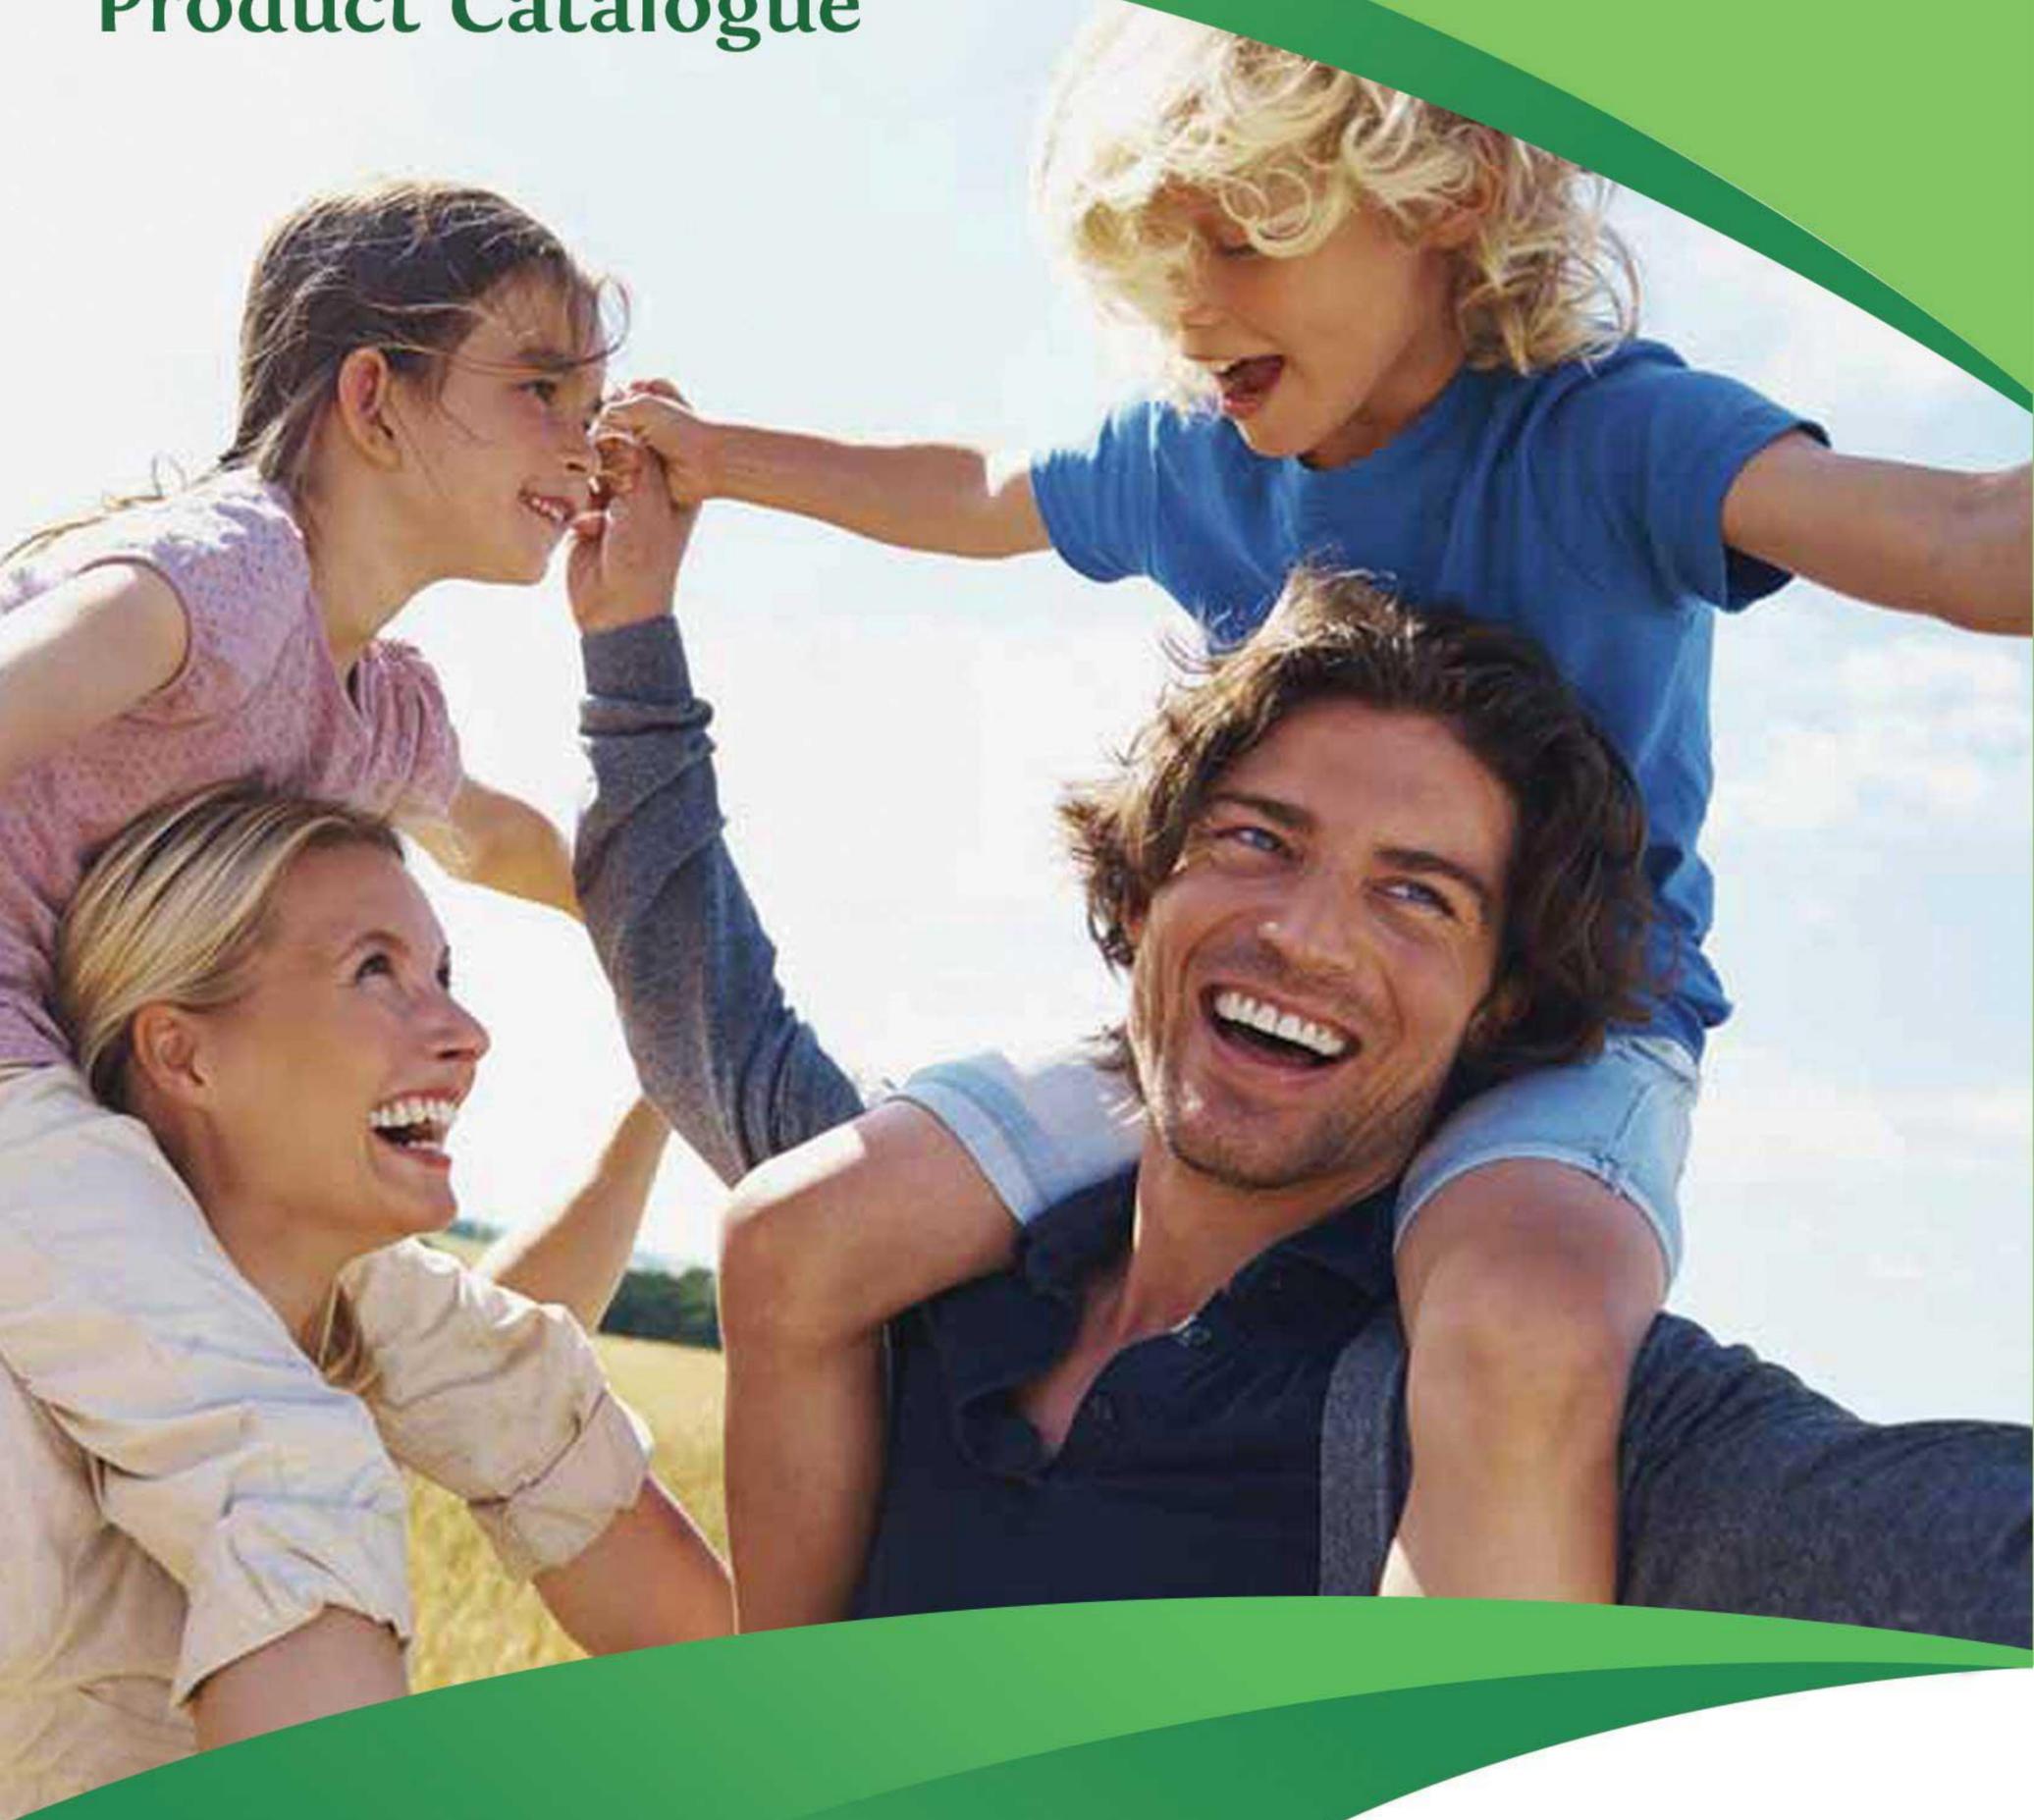

Sepid Tan Parniyan Co.

Manufacturer of Orthopedic &
Physiotherapy Appliance



معرفی شرکت: شرکت سپید تن پرنیان پویش به شماره ثبت ۱۱۲۳ در سال ۱۳۹۲ با هدف تولید محصولات نوآورانه و طبق استانداردهای روز دنیا با همکاری عده ای از کارشناسان ارتز و پروتز تاسیس گردید. از آنجائیکه این شرکت متعهد به ارائه محصولات با کیفیت می باشد، موفق به دریافت گواهی نامه های بین المللی مدیریت کیفیت ISO ۱۳۴۸۵ و ISO ۹۰۰۱ از TCL استرالیا و IQC انگلستان گردید. همچنین با بررسی عملکردی و بالینی محصولات در مراکز علمی و دانشگاههای معتبر ایران توانسته ایم تاییدیه سلامت محصولات را دریافت نموده که گویایی اثر بخشی فعالیتهای علمی در این سازمان می باشد. در عین حال با پیاده سازی GMP موفق به دریافت پروانه های ساخت وسایل پزشکی در دو گروه تخصصی فیزیوتراپی و توانبخشی و دستگاه ها و لوازم عمومی پزشکی از سازمان غذا و دارو (IFDA) وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور به شماره های ۷۱۸۰۲۳۱۰ و ۳۳۹۳۶۲۰۲ گردیده ایم. این شرکت در سال ۱۳۹۳ عضو انجمن صنفی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی و دندان پزشکی و آزمایشگاهی کشور گردید و از سال ۱۳۹۶ با دریافت مجوز واحد فناور از پارک علم و فن آوری استان گلستان به عنوان یک شرکت دانش بنیان پارکی در حال فعالیت می باشد.

خط مشی کیفیت در سپید تن پرنیان، ما را مجاب کرده تا کیفیت محصولات و خدمات سازمان را تعهدی در بالاترین سطح سازمان بدانیم و آنرا مسئولیت فردی تمامی مدیران، سرپرستان و کارکنان این شرکت بدانیم.

بدین منظور در جهت نیل به اهداف فوق ، خط مشی کیفیت بر پایه های زیر بنا شده است.

- جلب رضایت مشتریان
- بهبود مستمر کیفیت محصولات و فرآیند ها مرتبط با آن
- افزایش آگاهی پرسنل

تلاش ما به منظور کسب رضایت مشتریان و ارتقاء سلامت و دانش سلامتی جامعه می باشد که در این راستا اقدام های عملی ذیل انجام میگیرد.

- تمامی محصولات تولیدی شرکت دارای ۶ ماه ضمانت کیفیت میباشند. این بدین معناست، چنانچه هر یک از محصولات شرکت حتی پس از استفاده توسط بیمار، طی ۶ ماه اولی که از خرید عامل فروش شرکت گذشته باشد دچار نقصان گردید و بروز این نقصان به دلیل استفاده غلط کاربر نبوده باشد آن مشتری میتواند با در اختیار داشتن بسته بندی مخدوش نشده محصول از خدمات گارانتی تعویض محصول استفاده نموده و با مراجعه به عامل فروشی که محصول را از ایشان خریداری نموده است محصول را جهت گارانتی به شرکت عودت نماید. (البته هزینه حمل و نقل محصول معیوب از مکان عامل فروش به شرکت بر عهده مشتری میباشد).

- تمامی محصولات دارای ۶ ماه گارانتی فروش میباشند. این بدین معناست، به شرط سالم بودن محصولات و بسته بندی آن تا شش ماه پس از خرید محصولات چنانچه عامل فروش شرکت موفق به فروش هر یک از محصولات خریداری شده خود از شرکت نگردد میتواند آن محصول را با محصولات پر فروش دیگر مورد نظر خود از محصولات مندرج در لیست محصولات شرکت تعویض نماید. (البته هزینه حمل و نقل محصول از مکان عامل فروش به شرکت بر عهده عامل فروش میباشد).

- ضمنا به عاملین فروشی که به اهداف فروش سالانه شرکت نائل آید، جوایز نفیسی اعطا می گردد.





Sepid Tan Parniyan Co.

Manufacturer of Orthopedic & Physiotherapy Appliance



◀ کولار سخت

کد: ۱۰/۰۵

موارد استفاده:

- صدمات دیسک سرویکال
- ساپورت بعد از جراحی
- فرکچر سرویکال
- اسپوندیلوزیس سرویکال



◀ کولار ریجید با فریم PE

کد: ۱۰/۰۴

موارد استفاده:

- استرین عضلات سرویکال
- اسپوندیلوزیس سرویکال
- ویژگی: فریم پلی اتیلن
- جداشونده جهت تنظیم دامنه حرکتی




◀ کولار نیمه سخت

کد: ۱۰/۰۳

موارد استفاده:

- آرتروز سرویکال
- اسپوندیلوزیس سرویکال
- صدمات دیسک سرویکال

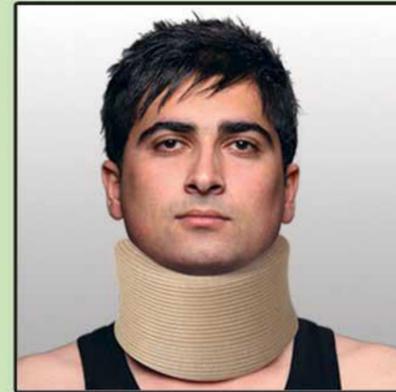

◀ کولار نرم

کد: ۱۰/۰۱

موارد استفاده:

- استرین عضلات سرویکال
- اسپوندیلوزیس سرویکال



◀ کولار فیلادلفیا (تراکستومی)

کد: ۱۰/۱۱

موارد استفاده:

- ساپورت بعد از جراحی
- فرکچر سرویکال
- اسپوندیلوزیس سرویکال
- استرین، اسپرین



◀ کولار فیلادلفیا

کد: ۱۰/۰۹

موارد استفاده:

- ساپورت بعد از جراحی
- فرکچر سرویکال
- اسپوندیلوزیس سرویکال
- استرین، اسپرین



◀ کولار بیسیک (تراکستومی)

کد: ۱۰/۰۸

موارد استفاده:

- آرتروز سرویکال
- فرکچر سرویکال
- اسپوندیلوزیس سرویکال



◀ کولار بیسیک

کد: ۱۰/۰۷

موارد استفاده:

- آرتروز سرویکال
- فرکچر سرویکال
- اسپوندیلوزیس سرویکال



Cervical



◀ کمر بند حاملگی

کد: ۲۰/۱۱

موارد استفاده:

- پیشگیری از کمردرد
- نگهداری رحم و جنین



◀ کمر بند ۴ فنره ۳۵ سانت

کد: ۲۰/۰۸

موارد استفاده:

- اسپوندیلوزیس
- اسپوندیلولیسترزیس
- پوسچر ضعیف
- استئو آرتريت
- استئوپروز



◀ کمر بند ۴ فنره ۳۰ سانت

کد: ۲۰/۰۷

موارد استفاده:

- اسپوندیلوزیس
- اسپوندیلولیسترزیس
- پوسچر ضعیف
- استئو آرتريت
- استئوپروز



◀ کمر بند ۴ فنره ۲۷ سانت

کد: ۲۰/۰۱

موارد استفاده:

- اسپوندیلوزیس
- اسپوندیلولیسترزیس
- پوسچر ضعیف
- استئو آرتريت
- استئوپروز



◀ بانداژ ترقوه با پد

کد: ۲۰/۴۲

موارد استفاده:

- فرکچر کلاویکل
- ساپورت بعد از جراحی



◀ کتف بند نئوپرنی

کد: ۲۰/۴۰

موارد استفاده:

- پوسچر ضعیف
- ضعف عضلات اسکاپولا
- سندرم راند شولدر



◀ TLSO نرم

کد: ۲۰A/۱۳

موارد استفاده:

- اسکولیوزیس مایلد
- پوسچر ضعیف



◀ کمر بند حاملگی دو تکه

کد: ۲۰/۱۲

موارد استفاده:

- نگهداری مناسب رحم و جنین
- پیشگیری از درد کمر و پا





Sepid Tan Parniyan Co.

Manufacturer of Orthopedic & Physiotherapy Appliance



LSO سخت (با کاور) ◀

کد: ۲۲/۰۸

موارد استفاده:

- بعد از جراحی ستون فقرات بین مهره های L1 تا S1



LSO سخت (سگک دار ولکرو دار) ◀

کد: ۲۲/۰۴

موارد استفاده:

- بعد از جراحی ستون فقرات بین مهره های L1 تا S1



TLSO نیمه سخت ◀

کد: ۲۱/۰۲

موارد استفاده:

- فتق دیسک بین مهره ای
- کایفوز
- اسپانديلولیسیس
- اسپونديلولیستیسیس
- سندرم فاست



کمر بند نیمه سخت ◀

کد: ۲۱/۰۱

موارد استفاده:

- اسپونديلولیسیس
- اسپونديلولیستیسیس
- استئو آرتريت
- استئوپروز



کمر بند قرقره ای با سیستم ◀

۱ به ۶ (LSOFLEX)

کد: ۲۳/۰۱

موارد استفاده:

- استرین/اسپرین
- اسپانديلولیسیس
- اسپونديلولیستیسیس



TLSO سخت (ولکرو دار) ◀

کد: ۲۲/۱۹

موارد استفاده:

- آسیب دیدگی بین مهره های T۳ تا S۱ ستون فقرات
- درد کمر و آسیبهای دیسک
- اسپانديلولیسیس
- ایجاد بیحرکتی بعد از عمل



TLSO سخت (سگک دار) ◀

کد: ۲۲/۱۷

موارد استفاده:

- آسیب دیدگی بین مهره های T۳ تا S۱ ستون فقرات
- درد کمر و آسیبهای دیسک
- اسپانديلولیسیس
- ایجاد بیحرکتی بعد از عمل



TLSO سخت (با کاور) ◀

کد: ۲۲/۱۴

موارد استفاده:

- آسیب دیدگی بین مهره های T۳ تا S۱ ستون فقرات
- درد کمر و آسیبهای دیسک
- اسپانديلولیسیس
- ایجاد بیحرکتی بعد از عمل



Spine



◀ کمر بند قرقره ای با سیستم قرقره ای DLSO (DLSORFLEX) ۱ به ۶

کد: ۲۳/۲۱

موارد استفاده:

- اسپاندیلو لیسسیس
- اسپوندیلو لیستزیس
- بعد از جراحی ستون فقرات بین مهره های T8 تا S1

◀ LSO با سیستم قرقره ای (LSORFLEX) ۱ به ۶

کد: ۲۳/۱۹

موارد استفاده:

- اسپاندیلو لیسسیس
- اسپوندیلو لیستزیس
- بعد از جراحی ستون فقرات بین مهره های L1 تا S1

◀ کمر بند قرقره ای با پد ۳۰ سانت ۱ به ۶ (LSOFLEX)

کد: ۲۳/۰۷

موارد استفاده:

- اسپاندیلو لیسسیس
- اسپوندیلو لیستزیس
- بعد از عمل دیسککتومی / فیوژن

◀ کمر بند قرقره ای با سیستم LO ۱ به ۶ (LSOFLEX)

کد: ۲۳/۰۳

موارد استفاده:

- اسپاندیلو لیسسیس
- اسپوندیلو لیستزیس
- بعد از عمل دیسککتومی / فیوژن



◀ نگهدارنده قفسه سینه

کد: ۲۴/۰۳

موارد استفاده:

- فرکچر دنده
- استرین عضلات بین دنده های
- بعد از جراحی باز قلب

◀ جناغ بند سگک دار

کد: ۲۴/۰۲

موارد استفاده:

- فرکچر دنده
- استرین عضلات بین دنده های
- بعد از جراحی باز قلب

◀ TLSO با سیستم قرقره ای (TLSORFLEX-T2) ۱ به ۶

کد: ۲۳/۲۷

موارد استفاده:

- آسیب دیدگی بین مهره های T۳ تا S۱ ستون فقرات
- اسپاندیلو لیسسیس
- اسپوندیلو لیستزیس

◀ TLSO با سیستم قرقره ای (TLSORFLEX) ۱ به ۶

کد: ۲۳/۲۳

موارد استفاده:

- آسیب دیدگی بین مهره های T۳ تا S۱ ستون فقرات
- اسپوندیلو لیستزیس





Sepid Tan Parniyan Co.

Manufacturer of Orthopedic & Physiotherapy Appliance



◀ شانه بند

کد: ۳۰/۰۱

موارد استفاده:

- تاندونیت روتاتورکاف
- بورسیت شانه
- بی ثباتی شانه



◀ شکم بند الاستیک پل دار

کد: ۲۵/۱۰

موارد استفاده:

- جلوگیری از تجمع مایع بین بافتها
- بعد از زایمان، سزارین، لیپوساکشن



◀ شکم بند ساده الاستیک

کد: ۲۵/۰۲

موارد استفاده:

- جلوگیری از جمع شدن مایع بین بافتها پس از عمل جراحی
- بعد از زایمان، سزارین، لیپوساکشن



◀ شکم بند لاغری نئوپرنی

کد: ۲۵/۰۱

موارد استفاده:

- پس از عمل لیپوساکشن کوچک نمودن شکم
- گرم نگه داشتن کمر، کلیه و شکم



◀ ثابت کننده شانه و بازو

کد: ۳۰/۰۸

موارد استفاده:

- ساپورت شانه و بازو بعد از جراحی و شکستگی
- صدمات عصب بر اکیال




◀ آویز دست پشت بسته

کد: ۳۰/۰۳

موارد استفاده:

- صدمات عصب بر اکیال
- فرکچر قسمت فوقانی
- هومروس
- در رفتگی و ناپایداری شولدر
- ساپورت بعد از جراحی

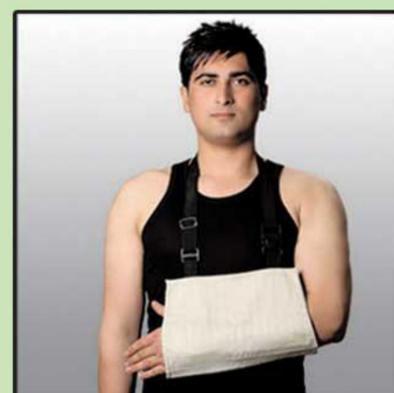

◀ آویز دست پشت باز

کد: ۳۰/۰۲

موارد استفاده:

- بی حرکت کردن شانه - بازو - ساعد
- کشیدگی عضلات بازو و ساعد
- سندرم تنیس البو



Shoulder



- ◀ دور کننده شانه وج دار
۴۵°-۷۰°
کد: ۳۰/۲۰
موارد استفاده:
• قابلیت تنظیم ابداکشن شانه
بین ۴۵° و ۷۵°
• بعدازجراحی روتاتورکاف
در رفتگی شانه
• آکرومیوپلاستی
• فرکچر غیرقابل جراحی
• بی حرکتی در فرکچر



- ◀ دور کننده شانه مثلثی
سه تیکه
کد: ۳۰/۱۸
موارد استفاده:
• قابلیت تنظیم ابداکشن
شانه بین ۳۰° تا ۴۵° و
قابلیت افزایش اکسترنال
روتیشن بین ۲۰° تا ۳۰°
• بعدازجراحی روتاتورکاف
در رفتگی شانه
• آکرومیوپلاستی
• فرکچر غیرقابل جراحی
• بی حرکتی در فرکچر



- ◀ دور کننده شانه ۶۰°
کد: ۳۰/۱۲
موارد استفاده:
• قابلیت تنظیم ابداکشن شانه
بین ۴۵° تا ۶۰°
• بعدازجراحی روتاتورکاف
در رفتگی شانه
• آکرومیوپلاستی
• فرکچر غیرقابل جراحی
• بی حرکتی در فرکچر



- ◀ دور کننده شانه ۳۰°
کد: ۳۰/۱۰
موارد استفاده:
• قابلیت تنظیم ابداکشن
شانه بین ۳۰° تا ۴۵°
• بعدازجراحی روتاتورکاف
در رفتگی شانه
• آکرومیوپلاستی
• فرکچر غیرقابل جراحی
• بی حرکتی در فرکچر

◀ دور کننده شانه ۳۰° (T2)

- کد: ۳۰/۲۳
موارد استفاده:
• قابلیت تنظیم ابداکشن شانه بین ۳۰° تا ۴۵°
• بعدازجراحی روتاتورکاف
در رفتگی شانه
• آکرومیوپلاستی
• فرکچر غیرقابل جراحی
• بی حرکتی در فرکچر





Sepid Tan Parniyan Co.

Manufacturer of Orthopedic & Physiotherapy Appliance



◀ آرنج بند (هوی)

کد: ۴۰/۰۶

موارد استفاده:

- آرنج ضعیف
- سندرم تنیس البو
- سندوم گلف البو
- بورسیت اولکرانون



◀ آرنج بند (مدیوم)

کد: ۴۰/۰۵

موارد استفاده:

- آرنج ضعیف
- اسپرین/استرین آرنج
- بورسیت اولکرانون



◀ آرنج بند (لایت)

کد: ۴۰/۰۴

موارد استفاده:

- آرنج ضعیف
- اسپرین/استرین آرنج



◀ باند تنیس البو

کد: ۴۰/۰۱

موارد استفاده:

- لترال اپی کوندیلیت (تنیس البو)
- مدیال اپی کوندیلیت (گلف البو)



◀ آرنج بند با مفصل مدرج

کد: ۴۰/۰۸

موارد استفاده:

- دررفتگی آرنج
- آرتروپلاستی آرنج
- فرکچر آرنج
- بازسازی لیگامان کولترال اولنار



◀ بی حرکت کننده آرنج

کد: ۴۰/۰۷

موارد استفاده:

- بعد از جراحی
- کشیدگی عضلات



Elbow



◀ مچ بند دست فانکشنال (هوی)
کد: ۵۰/۰۶
موارد استفاده:
• سندرم تونل کارپال
• فرکچر کالیس
• بعد از جراحی



◀ مچ بند دست (هوی)
کد: ۵۰/۰۵
موارد استفاده:
• سندرم تونل کارپال
• فرکچر کالیس
• بعد از جراحی



◀ مچ بند دست فانکشنال (مدیوم)
کد: ۵۰/۰۴
موارد استفاده:
• سندرم تونل کارپال
• فرکچر کالیس
• بعد از جراحی



◀ مچ بند دست فانکشنال (لایت)
کد: ۵۰/۰۲
موارد استفاده:
• سندرم تونل کارپال
• بعد از صدمات بافت نرم



◀ مچ بند شست دار دست فانکشنال (لایت)
کد: ۵۰/۱۰
موارد استفاده:
• سندرم دکوروان
• بی ثباتی مفصل مچ
• مچ ضعیف



◀ مچ بند دست (هوی) پارچه مخمل CTS
کد: ۵۰/۰۹
موارد استفاده:
• سندرم تونل کارپال
• فرکچر کالیس
• بعد از جراحی



◀ مچ بند دست فانکشنال (هوی) CTS
کد: ۵۰/۰۸
موارد استفاده:
• سندرم تونل کارپال
• فرکچر کالیس
• بعد از جراحی



◀ مچ بند دست (هوی) CTS
کد: ۵۰/۰۷
موارد استفاده:
• سندرم تونل کارپال
• فرکچر کالیس
• بعد از جراحی





Sepid Tan Parniyan Co.

Manufacturer of Orthopedic & Physiotherapy Appliance



◀ **باند مچ**
 کد: ۵۰/۱۴
 موارد استفاده:
 • مچ ضعیف
 • بی ثباتی مچ



◀ **مچ بند شست دار دست فانکشنال (هوی) CTS**
 کد: ۵۰/۱۳
 موارد استفاده:
 • سندرم تونل کارپال
 • سندرم دکوروان
 • بی ثباتی مچ و شست
 • بعد از تروما



◀ **مچ بند شست دار دست فانکشنال (هوی)**
 کد: ۵۰/۱۲
 موارد استفاده:
 • سندرم تونل کارپال
 • سندرم دکوروان
 • بی ثباتی مچ و شست
 • بعد از تروما



◀ **مچ بند شست دار دست فانکشنال (مدیوم)**
 کد: ۵۰/۱۱
 موارد استفاده:
 • سندرم تونل کارپال
 • سندرم دکوروان
 • بی ثباتی مچ و شست
 • بعد از تروما



◀ **آتل انگشت**
 کد: ۶۰/۰۵
 موارد استفاده:
 • استرین لیگامان
 • دفورمیتی انگشت
 • فرکچر انگشت



◀ **شست بند (هوی)**
 کد: ۶۰/۰۳
 موارد استفاده:
 • سندروم دکوروان
 • اسپرین یا استرین شست
 • دررفتگی مفصل
 • کارپومتاکارپال
 • درد شست



◀ **شست بند (مدیوم)**
 کد: ۶۰/۰۲
 موارد استفاده:
 • سندروم دکوروان
 • صدمات لیگامان کولترال
 • اولنار / رادیوس
 • آرتريت
 • دررفتگی مفصل
 • کارپومتاکارپال



◀ **شست بند (لایت)**
 کد: ۶۰/۰۱
 موارد استفاده:
 • سندرم دکوروان
 • اسپرین یا استرین شست
 • صدمات مفصل
 • کارپومتاکارپال



Hand



◀ هیپ ابداکشن پیلو ۳۰°

کد: ۷۰/۰۵

موارد استفاده:

- برای نگهداشتن هیپ در حالت ابداکشن بعد از عمل جراحی یا جراحت
- بمنظور جلوگیری از دررفتگی لگن



◀ پاولیک هارنس

کد: ۷۰/۰۴

موارد استفاده:

- در رفتگی مادر زادی هیپ در اطفال
- بازسازی حفره استابولوم



◀ نگهدارنده لگن

کد: ۷۰/۰۲

موارد استفاده:

- جهت ساپورت و محافظت از لگن
- بمنظور کاهش درد و کاهش حرکات اضافی لگن حین جابه جایی



◀ هیپ ساپورت نئوپرنی

کد: ۷۰/۰۱

موارد استفاده:

- بعد از جراحی توتال هیپ
- بعد از جراحی آتروپلاستی
- بعد از جراحی استئوتومی اصلاحی هیپ
- دررفتگی مکرر مفصل هیپ



◀ تثبیت کننده آنی لگن

بعد از ترما (T-POD)

کد: ۷۰/۰۸

موارد استفاده:

- جلوگیری از خونریزی داخلی لگن بعد از سانحه
- جلوگیری از آسیب بیشتر به رگ ها و شریان ها و اعصاب لگن بعد از سانحه
- بعد از جراحی لگن



◀ بهلر با ۲۵° زاویه ترکشن

کد: ۷۰/۰۷

موارد استفاده:

- جهت کمک به ترکشن کلکنوس و دیستال تیبیال
- جهت کمک به ترکشن دیستال فمورال و یا پراکسیمال





Sepid Tan Parniyan Co.

Manufacturer of Orthopedic & Physiotherapy Appliance



◀ زانو بند اسگود - شلاتر
کد: ۸۰/۰۴

موارد استفاده:

- سندرم اسگود-شلاتر
- سندرم جامپرز-نی



◀ زانوبند کشکک باز با پد
کد: ۸۰/۰۳

موارد استفاده:

- استرین / اسپرین زانو
- زانوی ضعیف
- آرتريت
- ناپایداری کشکک



◀ زانوبند کشکک بسته با پد
کد: ۸۰/۰۲

موارد استفاده:

- استرین / اسپرین زانو
- زانوی ضعیف
- آرتريت



◀ باند کشکک
کد: ۸۰/۰۱

موارد استفاده:

- تاندونیت کشکک
- سندرم اسگود-شلاتر
- سندرم جامپرز-نی



◀ زانوبند پالمبو
کد: ۸۰/۰۸

موارد استفاده:

- آرتريت مايلد
- استرین / اسپرین زانو
- بی‌ثباتی زانو و کشکک
- لترال تیلتینگ کشکک



◀ زانوبند چهار فنره
کد: ۸۰/۰۷

موارد استفاده:

- آرتريت
- استرین / اسپرین زانو
- بی‌ثباتی زانو
- بی‌ثباتی کشکک



◀ زانوبند دو فنره
کد: ۸۰/۰۶

موارد استفاده:

- آرتريت
- استرین / اسپرین مايلد
- زانوی ضعیف



◀ زانوبند قابل تنظیم
کد: ۸۰/۰۵

موارد استفاده:

- بی‌ثباتی زانو
- استرین / اسپرین مايلد
- صدمات لیگامان‌های
- کولترال



Knee



- ◀ بی حرکت کننده زانو سه تیکه
کد: ۸۰/۱۴
موارد استفاده:
- بعد از جراحی زانو
 - پس از اتمام دوره گچ گیری



- ◀ زانوبند مفصل دار مدرج توانبخشی (دومحوره فلزی)
کد: ۸۰/۱۱
موارد استفاده:
- بعد از جراحی زانو
 - ناپایداری کشکک
 - صدمات لیگامانها کولترال
 - اسپرین لیگامانی کروشیت



- ◀ زانوبند با مفصل مدرج (دومحوره فلزی)
کد: ۸۰/۱۰
موارد استفاده:
- بعد از جراحی زانو
 - ناپایداری کشکک
 - صدمات لیگامانها کولترال
 - اسپرین لیگامانی کروشیت



- ◀ زانوبند مفصل دار (دومحوره)
کد: ۸۰/۰۹
موارد استفاده:
- بعد از جراحی زانو
 - ناپایداری کشکک
 - صدمات لیگامانها کولترال
 - اسپرین لیگامانی کروشیت
 - اسپرین/استرین مایلد



- ◀ جوراب مقاومتی-آبی (ساق بند هیدرو تراپی)
کد: ۸۰/۳۰
موارد استفاده:
- تقویت عضلات پا
 - تسریع فرآیند ریکاوری
 - کمک به بهبود اختلالات تعادلی



- ◀ زانو بند کشکک بسته الاستیک (جفتی)
کد: ۸۰/۲۵
موارد استفاده:
- اسپرین/استرین مایلد
 - زانوی ضعیف



- ◀ زانو بند کشکک باز الاستیک (جفتی)
کد: ۸۰/۲۴
موارد استفاده:
- اسپرین/استرین مایلد
 - کندرومالاسی زانو
 - زانوی ضعیف



- ◀ بی حرکت کننده زانویک تیکه (اوزانسی)
کد: ۸۰/۲۳
موارد استفاده:
- بعد از جراحی زانو
 - پس از اتمام دوره گچ گیری





Sepid Tan Parniyan Co.

Manufacturer of Orthopedic &
Physiotherapy Appliance



- ◀ مچ بند پا ریجید رکابدار
کد: ۹۰/۰۵
موارد استفاده:
- استرین/اسپرین مچ پا
 - پیچ خوردگی نیمه حاد
 - بی ثباتی مزمن مچ پا




- ◀ مچ بند پا (هوی)
کد: ۹۰/۰۳
موارد استفاده:
- استرین/اسپرین مچ پا
 - آرتريت
 - بی ثباتی مچ پا



- ◀ مچ بند پا (مديوم)
کد: ۹۰/۰۲
موارد استفاده:
- بی ثباتی مچ پا
 - استرین/اسپرین مچ پا
 - آرتريت




- ◀ مچ بند پا (لايت)
کد: ۹۰/۰۱
موارد استفاده:
- بی ثباتی مچ پا
 - مچ پای ضعیف
 - آرتريت

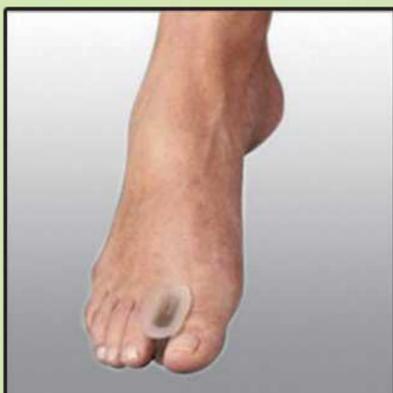

- ◀ پد لا انگشتی
کد: ۱۰۰/۰۴
موارد استفاده:
- سندرم هالوکس والگوس



- ◀ پد بانئون
کد: ۱۰۰/۰۳
موارد استفاده:
- درد بانئون
 - درمان جراحت روی بانئون

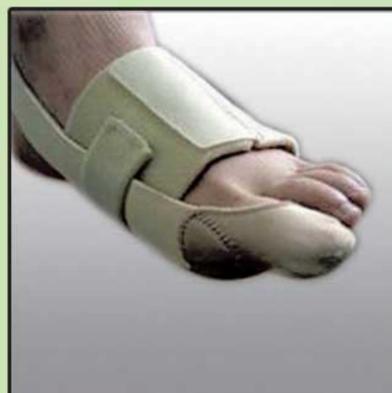

- ◀ اسپيلنت هالوکس والگوس نئوپرنی
کد: ۱۰۰/۰۱
موارد استفاده:
- سندرم هالوکس والگوس



- ◀ قوزک شست آرنج بند سه کاره
کد: ۹۰/۰۶
موارد استفاده:
- استرین/اسپرین
 - آرتريت



Ankle
& Foot




◀ کفی ارتوپدی

کد: ۱۰۰/۰۸

موارد استفاده:

- صافی کف پا
- پلاننار فشیاتیس
- کمردرد و درد کف پا و ساق
- هالوکس ریجیدوس
- اصلاح تاندون‌های تیبیال خلفی

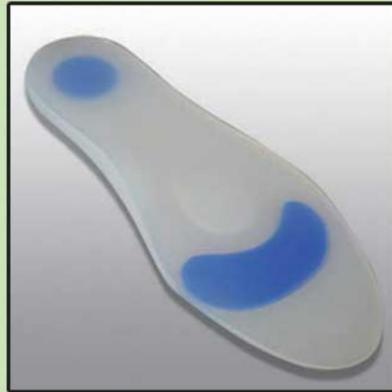

◀ کفی سیلیکونی (بلند)

کد: ۱۰۰/۰۷

موارد استفاده:

- پای دیابتیک
- پلاننار فشیاتیس
- بورسیت
- تالازیا
- متاتارسالژیا




◀ کفی سیلیکونی (کوتاه)

کد: ۱۰۰/۰۶

موارد استفاده:

- پای دیابتیک
- پلاننار فشیاتیس
- بورسیت

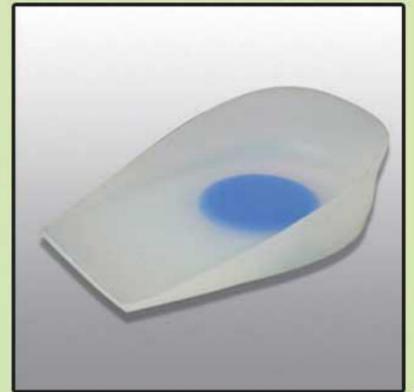

◀ پد پاشنه سیلیکونی

کد: ۱۰۰/۰۵

موارد استفاده:

- خار پاشنه
- درد پاشنه
- توزیع فشار
- فعالیت ورزشی
- شوک ابزوربر



◀ جوراب واریس

کد: ۱۱۰/۰۸

موارد استفاده:

- واریس اندام تحتانی
- واریس بارداری
- جلوگیری از لخته شدن خون در بیماران بستری
- مدل‌های موجود:

DF/ BD/ BF/ BG/ AD

AF/ AG



◀ کفش گچ

کد: ۱۰۰/۱۱

موارد استفاده:

- محافظت از گچ پا




◀ پاشنه پوش

کد: ۱۰۰/۱۰

موارد استفاده:

- ترک پاشنه / درد پاشنه

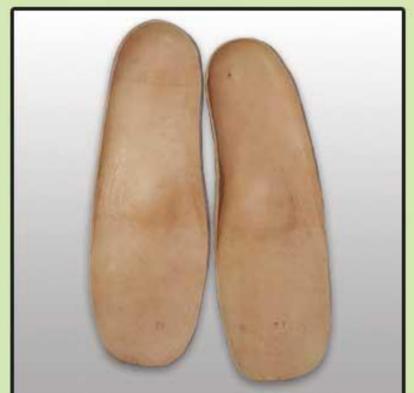

◀ کفی چرمی

کد: ۱۰۰/۰۹

موارد استفاده:

- فلت فوت





Sepid Tan Parniyan Co.

Manufacturer of Orthopedic & Physiotherapy Appliance



◀ استاکینت

کد: ۲۰۰/۱۰

موارد استفاده:

- زیر پروتز دست و پا،
- زیر ارتز
- زیر گچ قالب‌گیری



◀ پد استرپ

کد: ۲۰۰/۰۶

موارد استفاده:

- جهت جلوگیری از ایجاد فشار نقطه ای



◀ نگهدارنده نوزاد در تخت

کد: ۲۰۰/۰۴

موارد استفاده:

- جهت کنترل حرکات نوزاد در تخت بیمارستان



◀ جوراب پروتز

کد: ۲۰۰/۰۱

موارد استفاده:

- محافظت از پوست عضو قطع شده
- عرق‌گیر عضو قطع شده



◀ پد شکمی با سگک حلقه ای فلزی

کد: ۲۲/۲۵

موارد استفاده:

- جهت جلوگیری از ایجاد فشار نقطه ای در حفره شکمی



◀ پد شکمی (با استرپ تقویت شده)

کد: ۲۲/۲۳

موارد استفاده:

- جهت جلوگیری از ایجاد فشار نقطه ای در حفره شکمی



◀ پد شکمی حلقه دار

کد: ۲۲/۲۲

موارد استفاده:

- جهت جلوگیری از ایجاد فشار نقطه ای در حفره شکمی



◀ استرپ آماده زبر و نرم

کد: ۲۰۰/۱۴

موارد استفاده:

- جهت استفاده در ارتزهای مختلف



Clinical



◀ حلقه پلاستیکی فلزی (۵ سانت)

کد: ۲۰۰/۰۹

ویژگی:

- استحکام بالا
- حلقه متحرک فلزی
- در دوازده رنگ



◀ حلقه پلاستیکی فلزی (۲.۵ سانت)

کد: ۲۰۰/۰۸

ویژگی:

- استحکام بالا
- حلقه متحرک فلزی
- در دوازده رنگ



◀ پرچ پلاستیکی رزوه دار

کد: ۲۰۰/۰۷

ویژگی:

- سازگاری با ام آر آی
- رنگ: سفید




◀ بانداژ کشی

کد: ۲۱۰/۰۳

موارد استفاده:

- فیکس کردن مفصل آسیب دیده در آسیب های ناگهانی

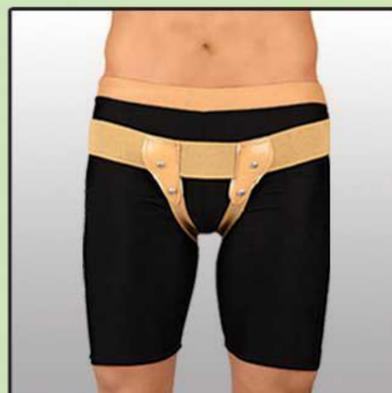

◀ فتق بند دوطرفه

کد: (۲۱۰/۰۲)

موارد استفاده:

- جهت پیشگیری از پیشرفت هر نیا اینگوینال



◀ فتق بند یک طرفه


کد: (۲۱۰/۰۱)


موارد استفاده:


- جهت پیشگیری از پیشرفت هر نیا اینگوینال






Neck measurement	Size
 32 - 36 cm	XS
36 - 40 cm	S
40 - 44 cm	M
44 - 48 cm	L
48 - 52 cm	XL

Waist measurement	Size
 70 - 80 cm	S
80 - 90 cm	M
90 - 100 cm	L
100 - 110 cm	XL
110 - 120 cm	XXL

Chest measurement (Shoulder)	Size
 64 - 74 cm	S
74 - 84 cm	M
84 - 94 cm	L
94 - 104 cm	XL
104 - 114 cm	XXL

Forearm measurement (Elbow)	Size
 21 - 23 cm	S
23 - 25 cm	M
25 - 27 cm	L
27 - 29 cm	XL
29 - 31 cm	XXL

Wrist measurement	Size
 18 - 19 cm	S
19 - 20 cm	M
20 - 21 cm	L
21 - 22 cm	XL

Knee measurement	Size
 29-32 cm	S
32-35 cm	M
35-38 cm	L
38-41 cm	XL
41-44 cm	XXL

Shin measurement	Size
 31 - 34 cm	S
34 - 37 cm	M
37 - 40 cm	L
40 - 43 cm	XL
42 - 46 cm	XXL

Insole measurement (Shoe Size)	Size
 36 - 37 - 38	S
39 - 40	M
41 - 42 - 43	L

Ankle measurement	Size
 22 - 24 cm	S
24 - 26 cm	M
26 - 28 cm	L
28 - 30 cm	XL



شرکت سپید تن پرنیان

تولیدکننده انواع وسایل کمک درمانی ارتوپدی و فیزیوتراپی



استان گلستان، کیلومتر ۳ جاده آق قلا - گرگان، شهرک صنعتی آق قلا پارک علم و فن آوری گلستان. کد پستی ۴۹۳۱۱۶۹۷۱۵
شماره تماس واحد فروش: ۰۱۷۳۲۲۲۶۴۹۰ و ۰۱۷۳۲۲۲۶۴۸۹
تلفکس: ۰۱۷۳۲۲۲۶۴۸۹
همراه واحد فروش: ۰۹۱۱۷۹۳۹۷۱۳ و ۰۹۱۰۲۷۱۰۳۱۰
همراه مدیریت: ۰۹۱۱۳۷۵۵۱۹۱ و ۰۹۱۲۰۲۵۵۱۹۱

www.curedmedical.com
info@curedmedical.com
@curedmedical, @stportho
@curedmedical, @stportho

